

仕 様 書

(物 品 購 入)

品 名	製 造 会 社 名	数 量 (単 位)	同 等 品 に つ い て (可 ・ 不 可)
	規 格 ・ 品 番		
AED (自動体外式除細動機)一式	<p>【例示品】 日本光電工業 (株) 製 AED-3100 カルジオライフ</p> <p>●AED (自動体外式除細動機。以下、AEDという。) 本体以外に以下の①から④まで全ての付属品を本体台数分つけること。</p> <p>①キャリングバッグ</p> <p>②除細動パッド2組 成人・小児共通パッドとすること。 1組は本体に装着し、もう1組は予備としてキャリングバッグに入れておくこと。 納品時に有効期限が2年以上あること。</p> <p>③バッテリー 待機寿命が4年以上のものを装着すること。</p> <p>④取扱説明書 (日本語) ※納入業者は設置施設の所管課と日程調整等の上、物品搬入及び操作説明等を行うとともに、既存の設置機器の処分を所管課と調整して行うこと。(これらに要する経費を含めること) ※請求書等の書類は、設置施設の所管課と確認の上、作成すること。 ※使用中のAEDの引き取りを条件とすること。 ※同等品を提示する場合、次の点を必ず満たすこと。</p> <p>1) JRC 蘇生ガイドライン 2020 に対応した機器であること。 2) 音声ガイドが日本語の機器であること。 3) 成人・小児用の切り替えについては、キーの挿入又はスイッチ切替等によるワンタッチ操作で対応可能な機器であること。 4) 本体保証期間が5年以上の機器であること。 5) 本体耐用期間が7年以上の機器であること。 6) AED 本体は、オンラインのリモート監視システムを利用できる機種であること。 7) リモート監視システムは、AED のセルフテストの結果を WEB 上で確認できること。</p>	15 セット	可

○入札参加資格について

高度管理医療機器等販売業の許可を証明する書類の写しを入札時に提出すること。
(提出されない場合は、入札に参加できません。)

- 納期 令和8年5月29日(金)
- 納入場所 仕様書別表のとおり
- 所管課 保健福祉課(担当者:山根 TEL:(0848)67-6205)

○ 納入方法

1 本仕様書別表記載の設置施設の所管課と納入日時を日程調整の上、所管課が指示する場所に搬入、設置、調整、稼動開始及び確認を行い、納入を完了すること。

2 納入完了後10日以内に、「納入物品詳細報告書(任意の様式)」を作成し速やかに発注依頼課(保健福祉課)へ提出すること。

※納入物品詳細報告書には、納入場所、型番、シリアル番号(ロケット番号)等の個体識別情報、有効期限(下記注1)を記載すること。

(注1) 有効期限とは納入したAED本体、パッド、バッテリーの各々の使用可能な期間の終期をいう。但し、厳密な有効期限を示すことが困難な場合は、推奨される使用可能な期間の終期を有効期限とみなすことを可とする。

仕 様 書 別 表

設置施設及び所管課

設置施設	台数	設置施設の所管課
小佐木港待合所	1	港湾課 電話 (0848-67-6107)
三原市総合保健福祉センター	1	保健福祉課 電話(0848)67-6234
三原市大和保健福祉センター	1	
三原市本郷保健福祉センター	1	
三原市保健福祉課 (貸出用)	1	
三原市人権文化センター	1	人権推進課 電話(0848)66-1111
三原市本郷人権文化センター	1	
三原市宇根山家族旅行村	1	生涯学習課 電話(0848)67-6148
三原市糸崎コミュニティセンター	1	
三原市中之町コミュニティセンター	1	
三原市中央公民館	1	
旧三原市立久井小学校 (体育館)	1	スポーツ振興課 電話 (0848) 64-7219
旧三原市立久井南小学校 (体育館)	1	
旧三原市立和木小学校 (体育館)	1	
三原市立本郷ひまわり保育所	1	こども保育課 電話 (0848-67-6042)

<仕様書の補足説明> AED本体以外の付属品について


① 壁かけホルダについて

令和8年度に更新するAEDについては、AED本体と壁掛けホルダが異なるメーカーである場合も、使用可能であることを確認しており、今回の付属品に含めなくてもいいことを所管課に確認したため、付属品は仕様書のとおりとします。



日本光電の壁掛けホルダに、フィリップスFRx (FRxとFRx+では大きさ変化無し)が入る。(日本光電の壁掛けホルダは、幅・厚みともにネジである程度の調節が可能。)

置いただけの時 押し込んだ時

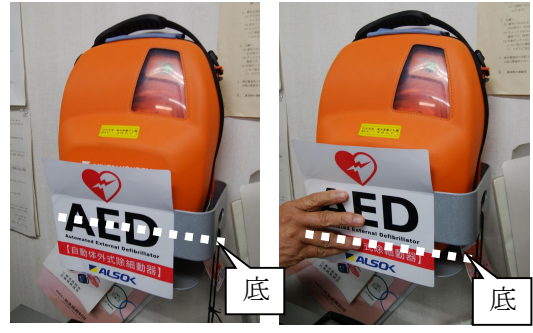

フィリップスの壁掛けホルダに、日本光電カルジオライフ3100が入る。(置いただけでは安定しない。押し込めばAED本体の底は浮いているが、安定する。)

②救急セット (蘇生用マスク、カミソリ等) について

救急セットについては、次の2点により、仕様書に含めておりません。

- ・既に蘇生用マスク等を備えている施設があること。
- ・JRC蘇生ガイドライン2020において、市民におけるBLSアルゴリズム (図1参照) としては、胸骨圧迫 (心臓マッサージ) としており、人工呼吸については「人口呼吸の技術と意思があれば」とされていること。

